
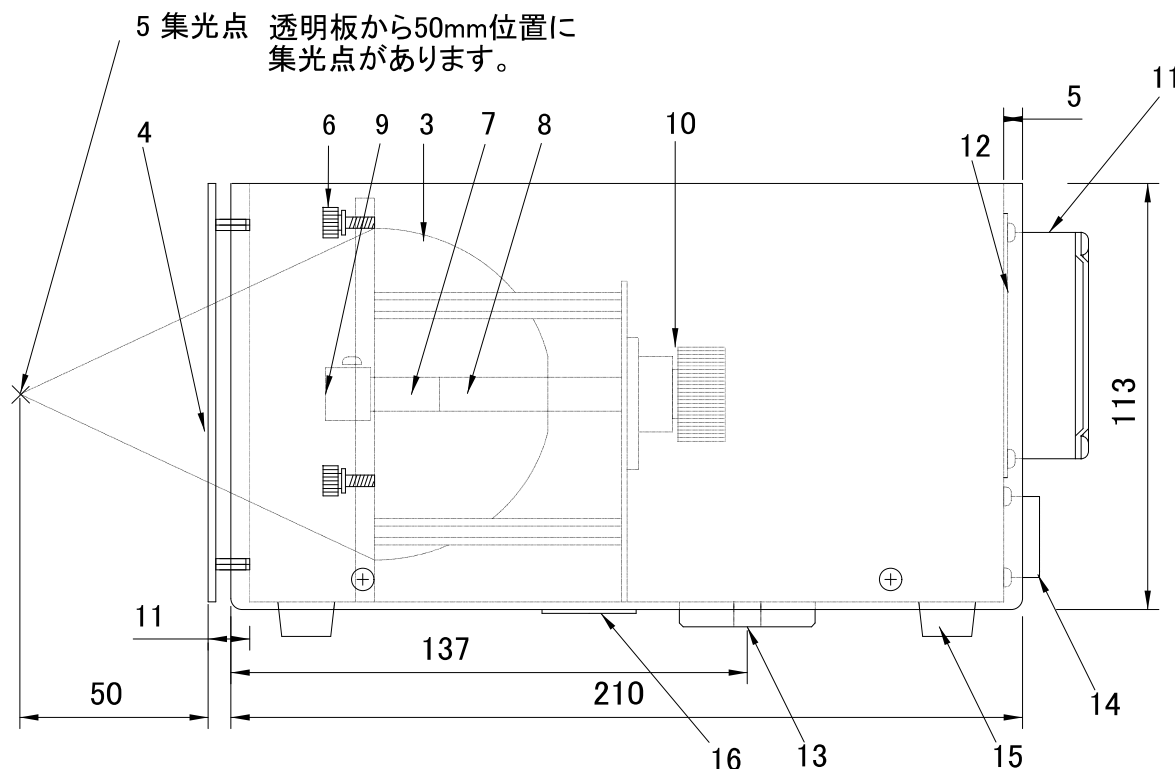


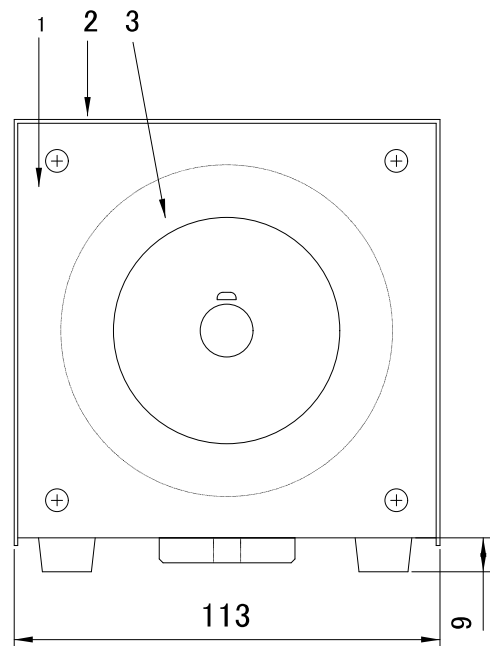

※
9.ランプ+極 接続用キャップ°
10.ランプー極部兼固定用キャップ° はともに
しっかりと締め付けて下さい。ランプ故障の原因となります

ケース材料 SPC t=1mm
表面仕上げ 焼付塗装(青レザー色)

1. ケースベース
2. ケースカバー
3. 放物ミラーΦ88
4. 透明アクリル板
5. 集光点
6. 集光点位置調整ビス
7. キセノンランプ SAX-100×1本
8. ランプ発光点
9. ランプ+極 接続用キャップ
10. ランプー極部兼固定用キャップ
11. 空冷用ファン
12. ランプ交換口プレート
13. ランプハウス固定用プレート(1/4"タッパアリ)
14. ランプコネクタ 七星製NR205RM
15. プラスチック足
16. ランプユニット位置調整用ビス

外形寸法 W113.H113.D210mm
(突起部除く)

画像処理用ストロボ照明					型式	LH-SA2M,LH-SA2S	
24.05.02					ショートアークストロボ ランプハウス		
					日進電子工業株式会社		
				製造	割合	目安	

Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			